

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强烈撞击；

3、不要使用温度或具有发性的液体擦拭设备；

1.1 1
1.2 1

2.1 2
2.2 3
2.3 4

3.1 5
3.2 6

4.1 7
4.2 7
4.2.1 7
4.2.2 8
4.3 8
4.3.1 8
4.3.2 9
4.3.3 9
4.3.4 9

5.1 10
5.2 11
5.3 .....

6.4 14
6.5 16
6.6 16

7.1 17
7.2 18
7.3 18
7.4 19
7.5 19
7.6 20

M TCP/IP

DC 24V 200mA

300mA -10 +55

95%

CMOS 200W


123° 3.5mm


0 lux


LCD 7”


600×1024

(W/H/D) 148.5×

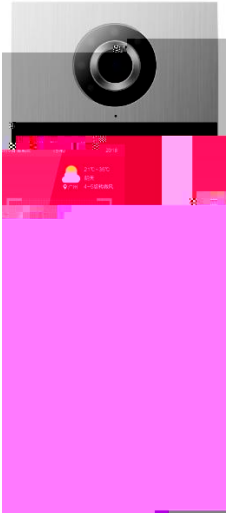

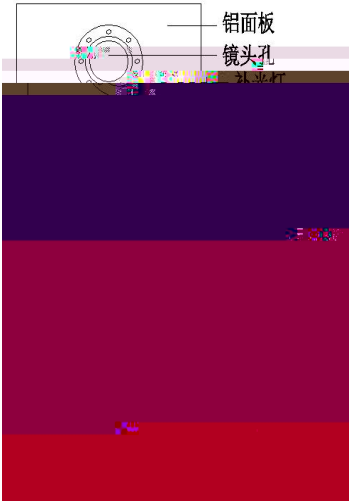
铝面板
镜头孔

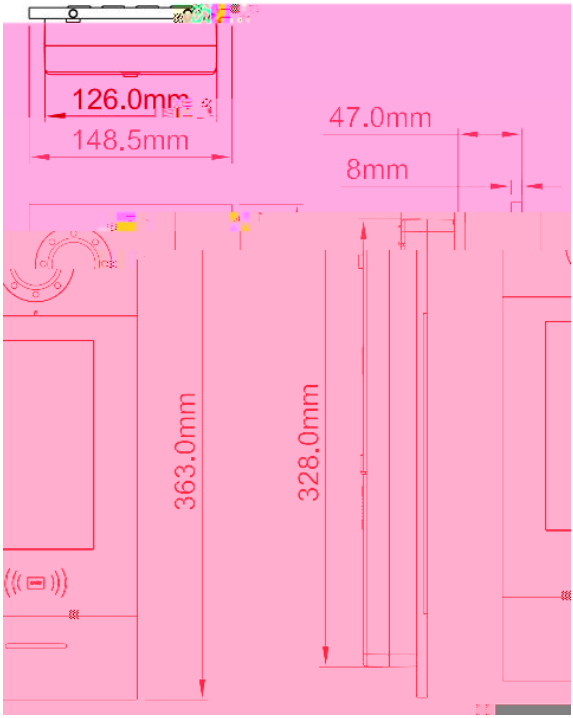
126.0mm
148.5mm
47.0mm
8mm
363.0mm
328.0mm

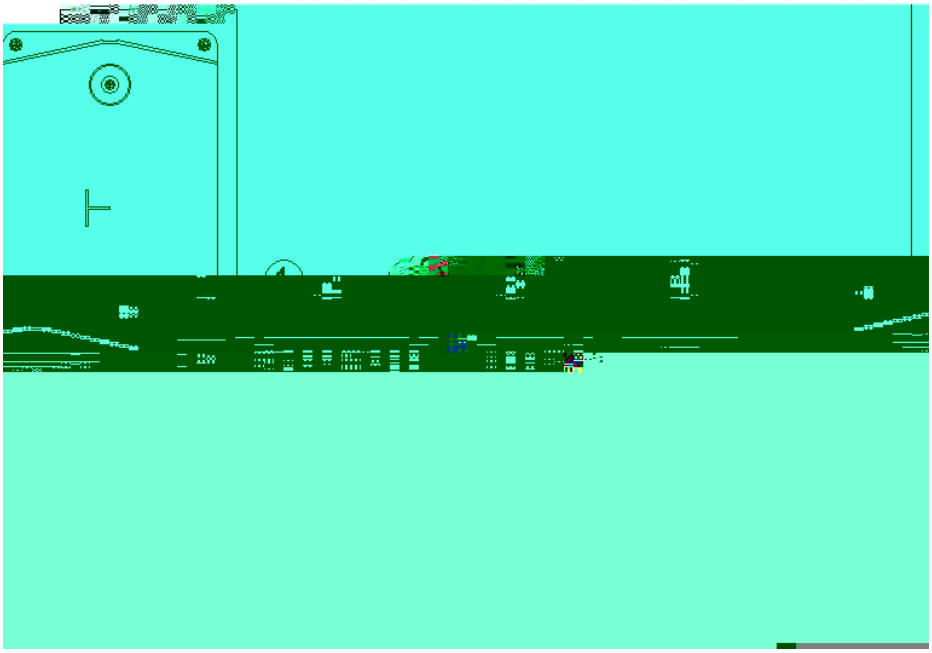



DC 24V DC 18-30V

+12V >18V

2


W/H/D 1

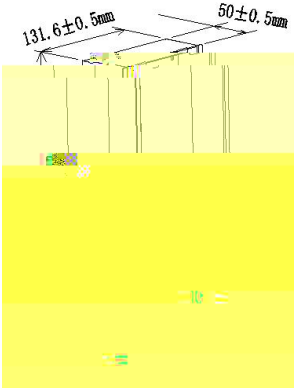


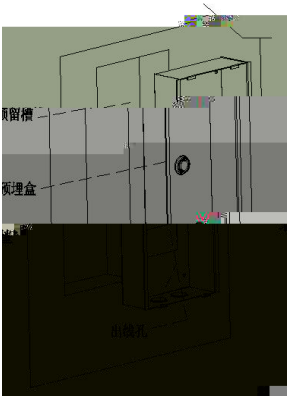


3

4

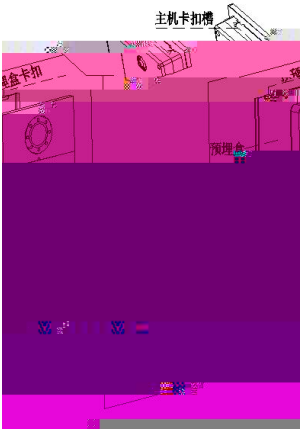

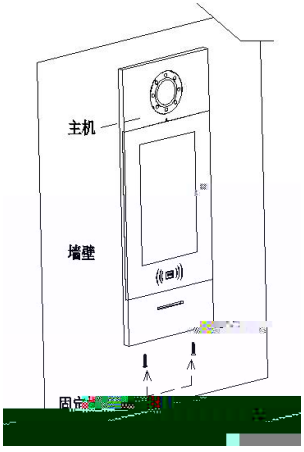

5

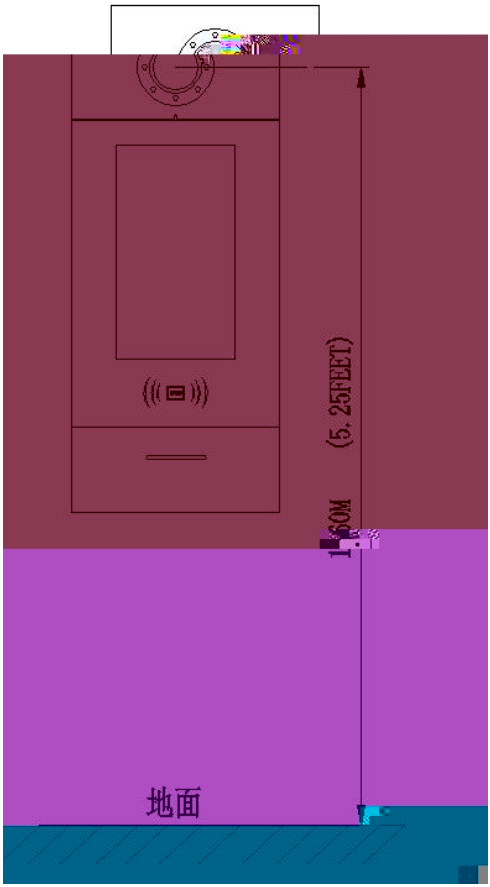

1.6









1





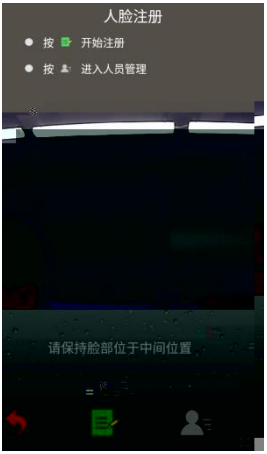



请输入工程密码
密码:
1
2
3
4
5
6
0
设置
系统设置
工程设置
系统设置
声音设置
日期和时间
开锁设置
门禁卡管理

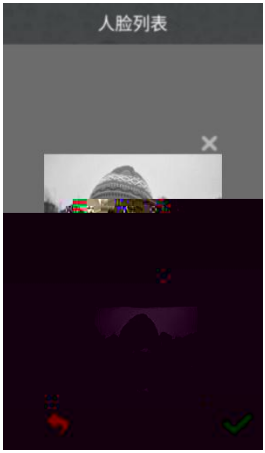
人脸列表





1 

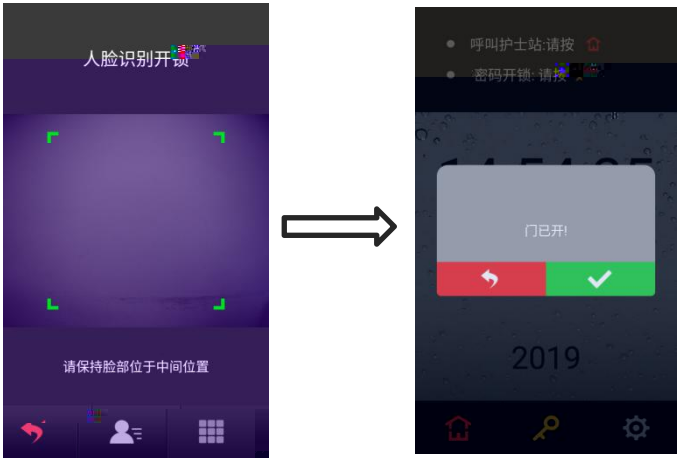

2


3 

1 

2



3 5678

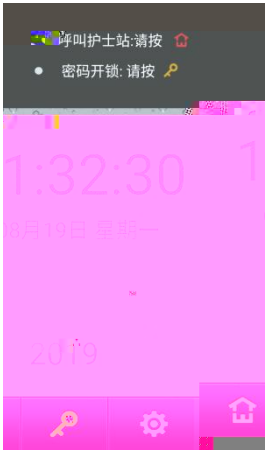



“2718”









系统设置
声音设置
日期和时间
开锁设置
门禁卡管理






声音设置
回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关

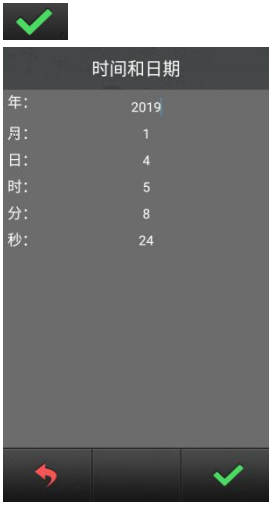
时间和日期
年:
2019
月:
1
日:
4
时:
5
分:
8
秒:
24



开锁设置
人脸识别开关
公共密码开关
公共密码修改








	20000

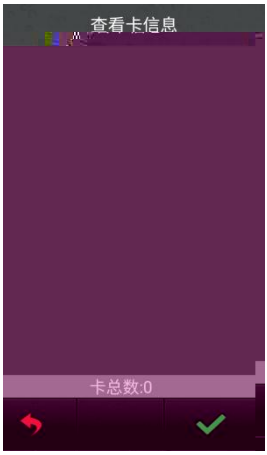
查看卡信息
卡总数:0


“ ” “ ” 



“•” 

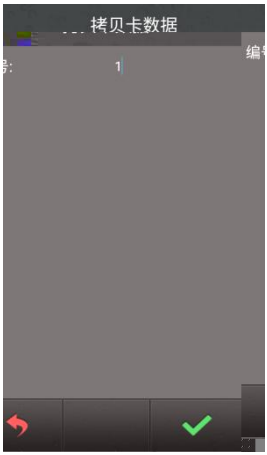
拷贝卡数据
1

“ ” 

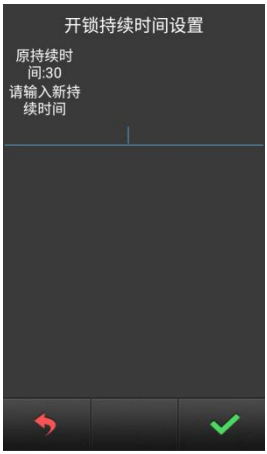
开锁持续时间设置
原持续时
间:30
请输入新持
续时间



顺序
关
开


韦根顺序
正序
反序



工程设置
设备属性
出厂测试
工程密码设置
公司信息
版本号
设备授权
升级

“•” ip


设备属性
设备类型:
病区门口机
服务器:
192.168.195.168
端 口:
8086
设备ip:
192.168.195.117
掩 码:
255.0.0.0
网 关:
192.168.192.2
设备号:
000130

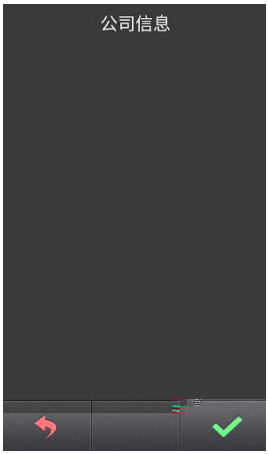
公司信息

IP MAC

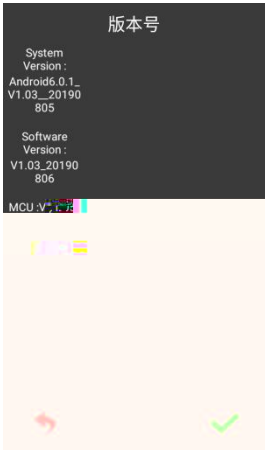
版本号
System Version :
Android6.0.1_V1.03_20190805
Software Version :
V1.03_20190806
MCU :V


设备授权
设备已授权