电子床头卡 产品手册_V1.0

M-BS03



● 产品概述

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□

● 功能特点

- ➢ □□□□□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□
- ➢ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□

●

□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□μA

□□□□□□□

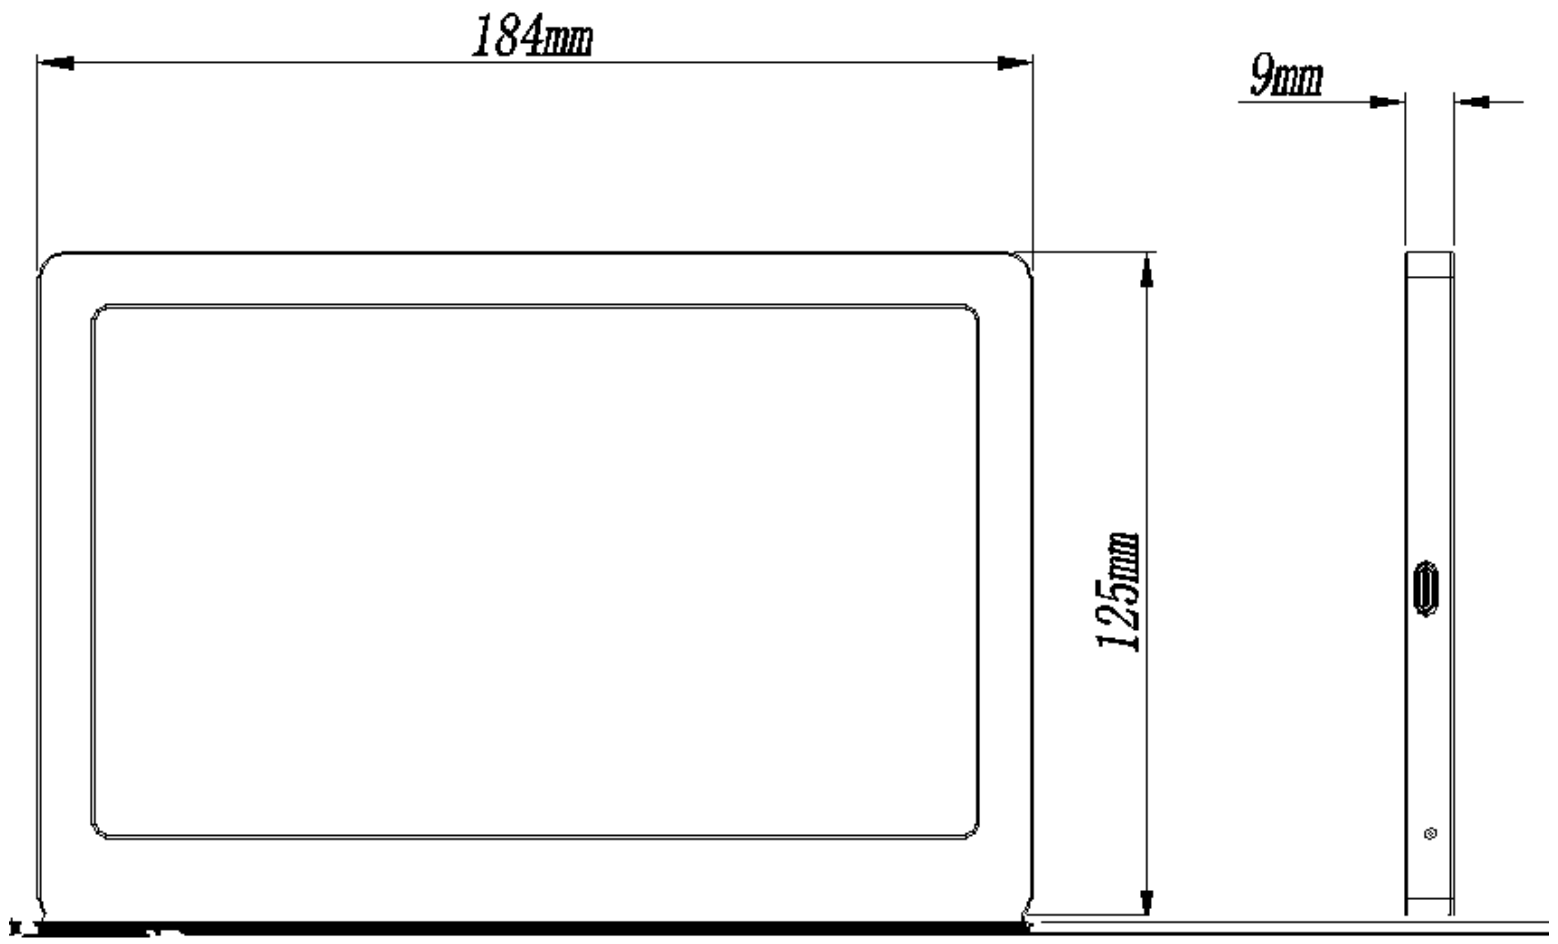
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□


● 产品

□□□□(L×W×D): 184×125×9 mm



● □ □ □ □

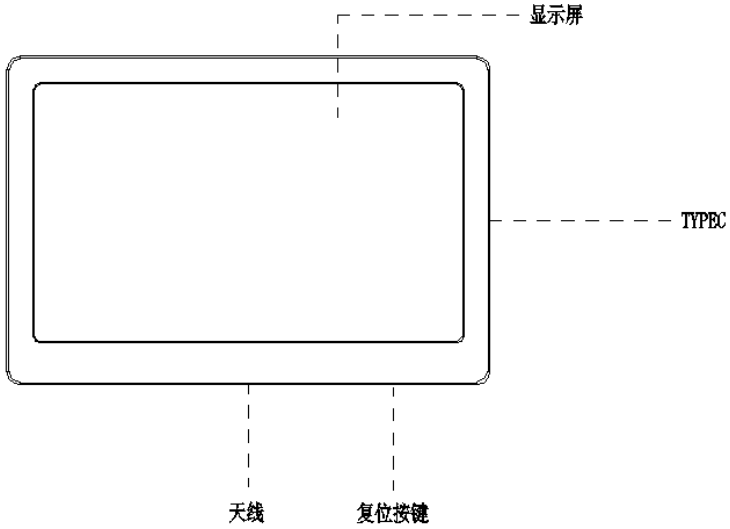外 ┘



┘ 、

Type-c 充电接口；

天线 用于增强 LoRa 信号；

复位按键 用于复位。

用 示、

本产品需 人员配置好电子床头卡系 。

患者信息、

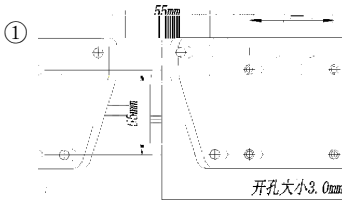
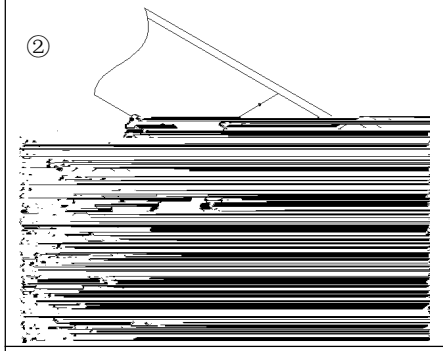
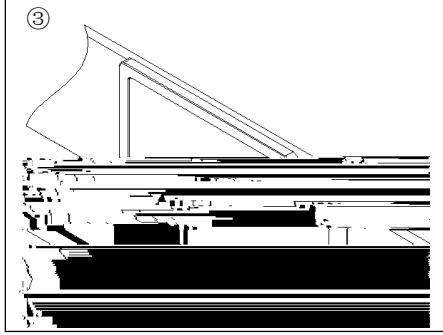
1、医护人员 医院系 入、 患者信息；

2、电子床头卡 自动 新 入、 的患者信息。

电 电 、

后台服务器可查看电子床头卡电池的使用情况。

● □ □ □ □

① 	第一步 ： 设备带 按图 1 挂 的 距离 。
② 	第二步 ： 用螺丝 挂 固定 设备带 ，然后 设备固定 挂 即可 成安装。
③ 	第三步 ： 安装 成后的状态。